

---

**ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ВЛАСНОГО ЕНЦЕФАЛОГРАФА ДЛЯ  
ДІАГНОСТИКИ МОЗКОВОЇ АКТИВНОСТІ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА**

Купін А.І., д.т.н., проф., Градовий О. В., аспірант

*Криворізький національний університет»*

В останні роки фундаментальні дослідження електричної активності мозку людини набувають все більшої актуальності. Пов'язано це з двома обставинами. По-перше, нейрофізіологічне вивчення мозку людини важливе для розуміння такого явища, як інтелект. По-друге, гострі потреби практики (медицина, оптимізація операторської діяльності і створення нейрокомп'ютерних інтерфейсів) постійно диктують необхідність інтенсифікувати і поглибити фундаментальні дослідження мозку людини. [1, 2]

Сучасні прилади є багатоканальні самописці (24 і більше каналів), які дозволяють одночасно реєструвати електричну активність від відповідного числа електродів, встановлених на голові обстежуваного. Самі ж електроди являють собою невеликі металеві пластини або стрижні.

Відмінності в потенціалах на шкірної поверхні голови мають маленьку амплітуду, в нормі - близько 100-150 мкв. Після зняття вони подаються на входи підсилюально-реєструючих пристрій. Основною проблемою є фільтрація сигналу від шуму на апаратному та програмному рівні. У якості підсилювача зазвичай використовуються інструментальні операційні підсилювачі з низьким внутрішнім шумом, близько 1 нв на Гц та великим коефіцієнтом підсилення, наприклад AD8429. Спрощена схема енцефалографа наведена на Рисунку 1. Електроди мають бути обладнані повторювачами сигналу для того, щоб сигнал не затухав при проходженні через кабель. Операційні підсилювачі живляться від бінополярного джерела живлення постійного струму. Джерело живлення не повинно пропускати шуми із мережі та мати постійну стабільну напругу. Це можна досягти за допомогою фільтру з конденсаторів C1, C2 та дроселю L1 або живлення від батареї. Для стабілізації напруги використовуються стабілітрони TL431. Схема має бути захищена екраном від радіонаведень.

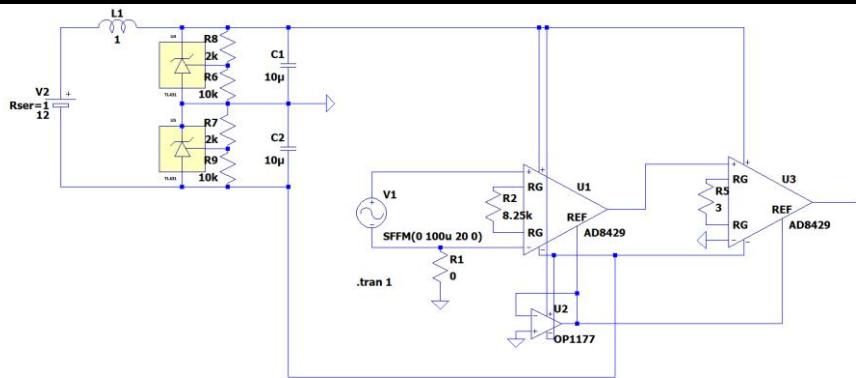


Рисунок 1 – схема джерела живлення та одного каналу підсилювача енцефалографа

Висновки. Отже енцефалографія – перспективний напрямок для неінвазивного дослідження мозку та побудови нейроінтерфейсів. Тому подальші дослідження авторів будуть пов’язані з розробкою та реалізацією власних апаратно-програмних засобів для подібних розробок.

### Література

1. “Active electrodes - research” Jarek Foltynski, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: [http://www.bioera.net/bw/ae/active\\_prototype3.html](http://www.bioera.net/bw/ae/active_prototype3.html)
2. “Устройство электроэнцефалографа” EEG analysis by CMI, [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://cmi.to/ээг/устройство-электроэнцефалографа/>